




طیف اولیه نمونه استاندارد کراندوم دستگاه بعد از تنظیمات در تاریخ ۹۷/۱۱/۱۰  
توان مورد استفاده دستگاه ۸۷۵ وات

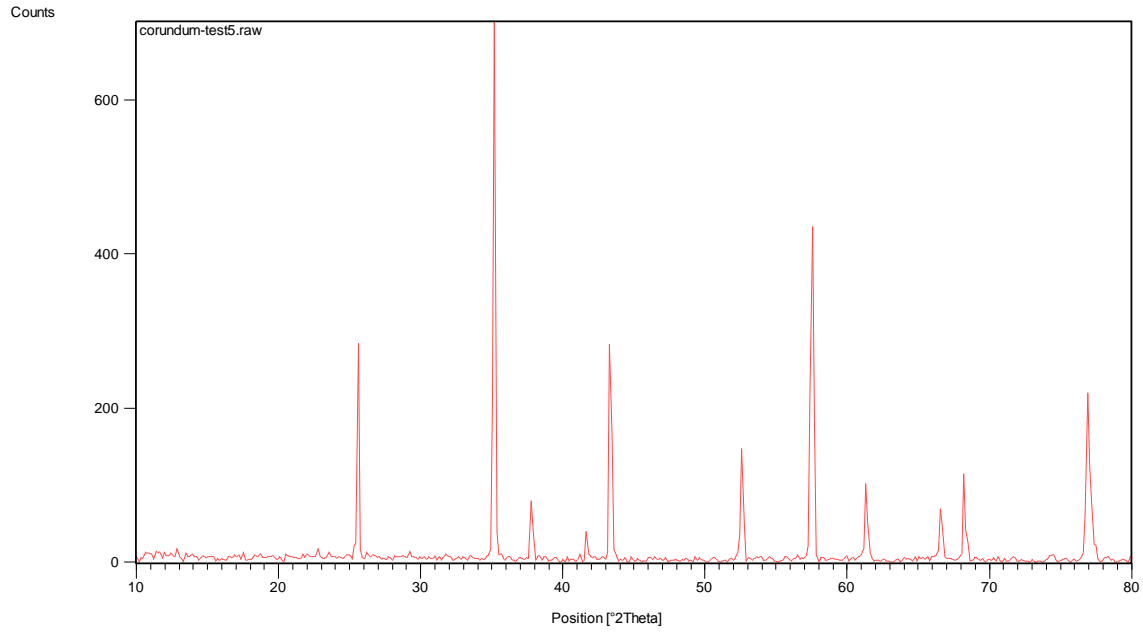


طیف اولیه نمونه استاندارد کراندوم دستگاه قبل از تنظیمات توسط شرکت بهنگر  
توان مورد استفاده دستگاه ۱۲۰۰ وات

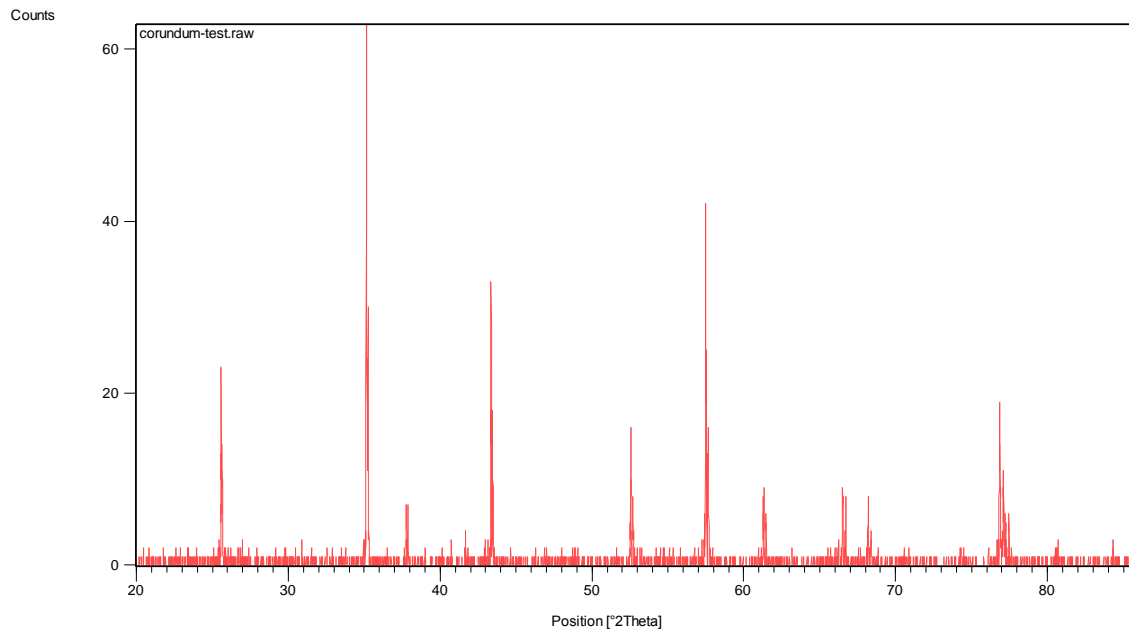


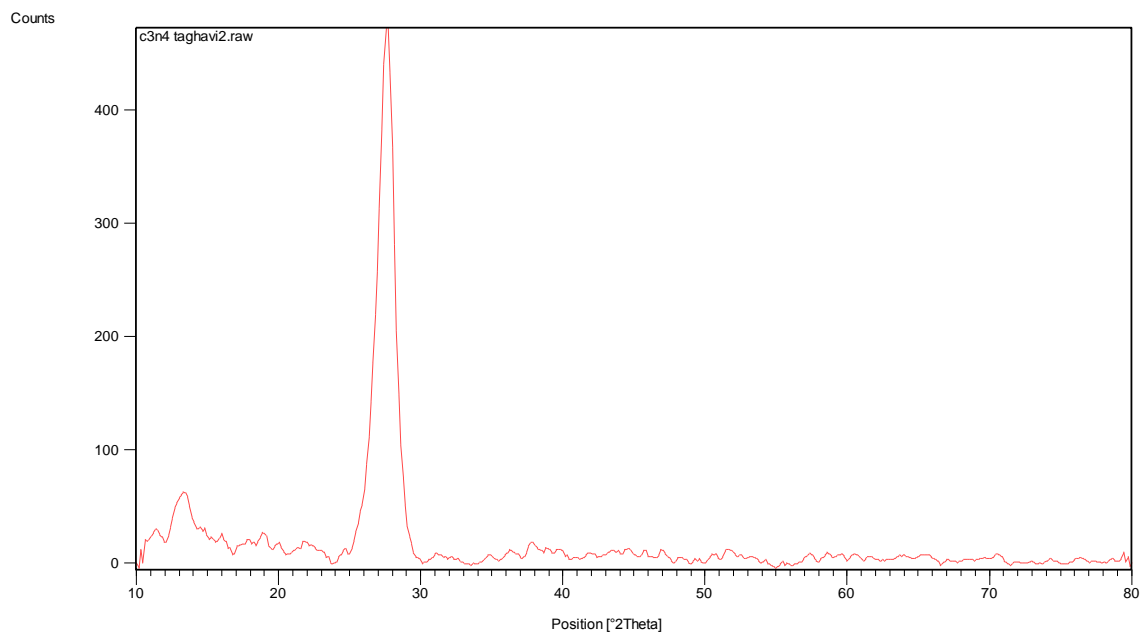


طیف اولیه نمونه آزمایشگاهی  $C_3N_4$  مربوط به دکتر رضانی بعد از تنظیمات در تاریخ ۹۷/۱۱/۱۰  
توان مورد استفاده دستگاه ۸۷۵ وات

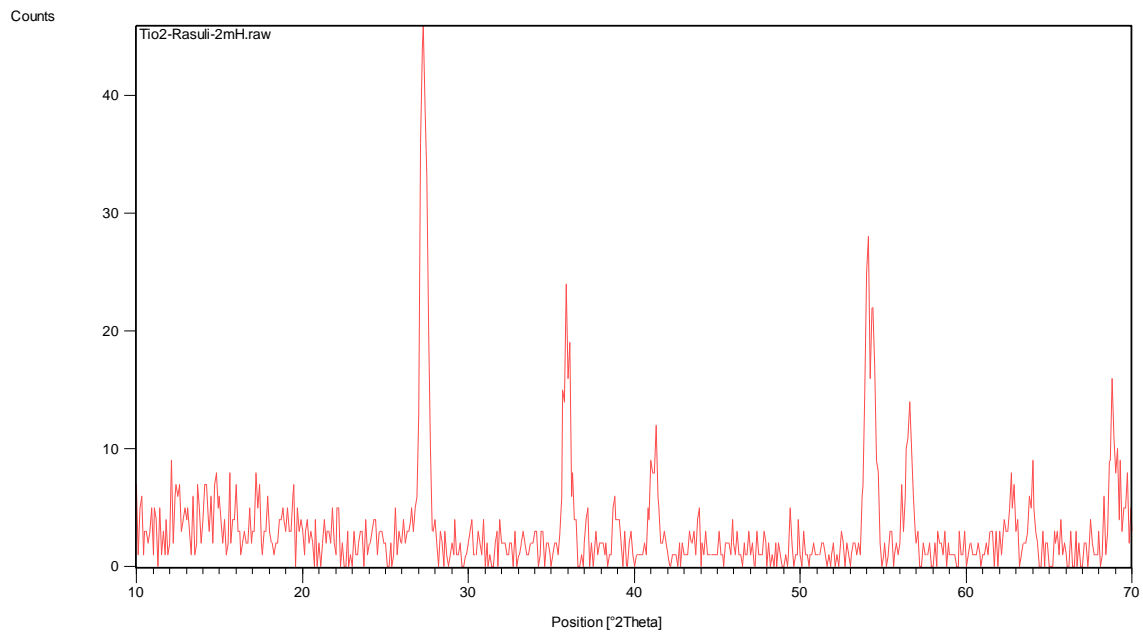


طیف اولیه نمونه آزمایشگاهی نانوذرات  $TiO_2$  مربوط به دکتر رسولی بعد از تنظیمات در تاریخ ۹۷/۱۱/۸

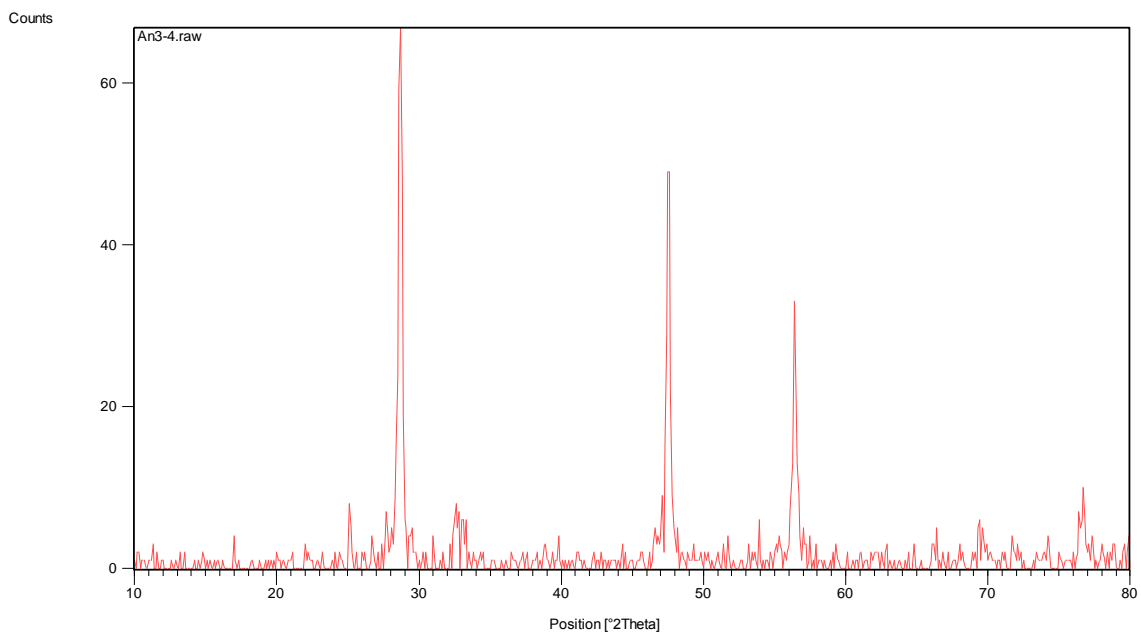


طیف اولیه نمونه خاک معدن انگوران مربوط به دکتر نباتیان بعد از تنظیمات در تاریخ ۹۷/۱۱/۸

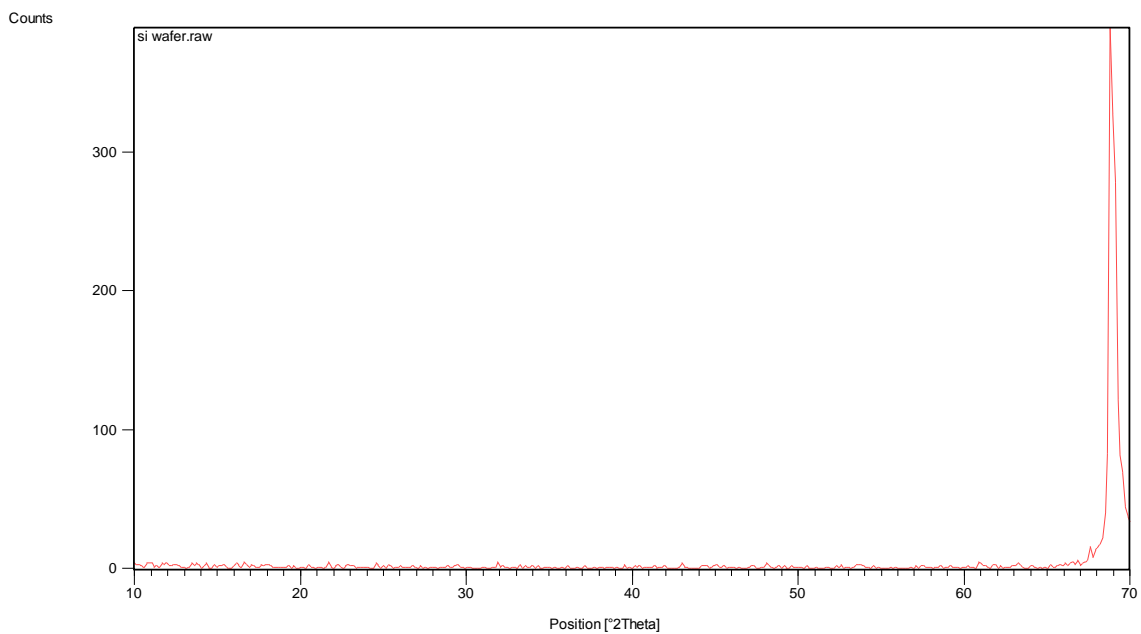


طیف اولیه نمونه ویفر سیلیکون تک کریستال مربوط به دکتر رسولی بعد از تنظیمات در تاریخ ۹۷/۱۱/۸

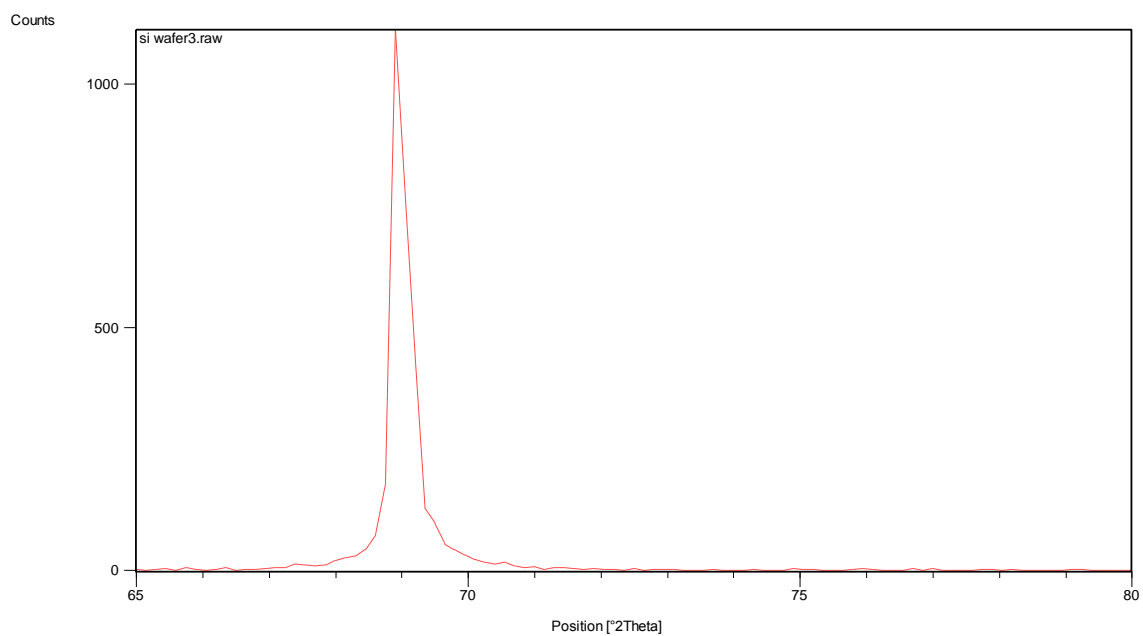


طیف اولیه زوم شده نمونه ویفر سیلیکون تک کریستال مربوط به دکتر رسولی بعد از تنظیمات در تاریخ ۹۷/۱۱/۸

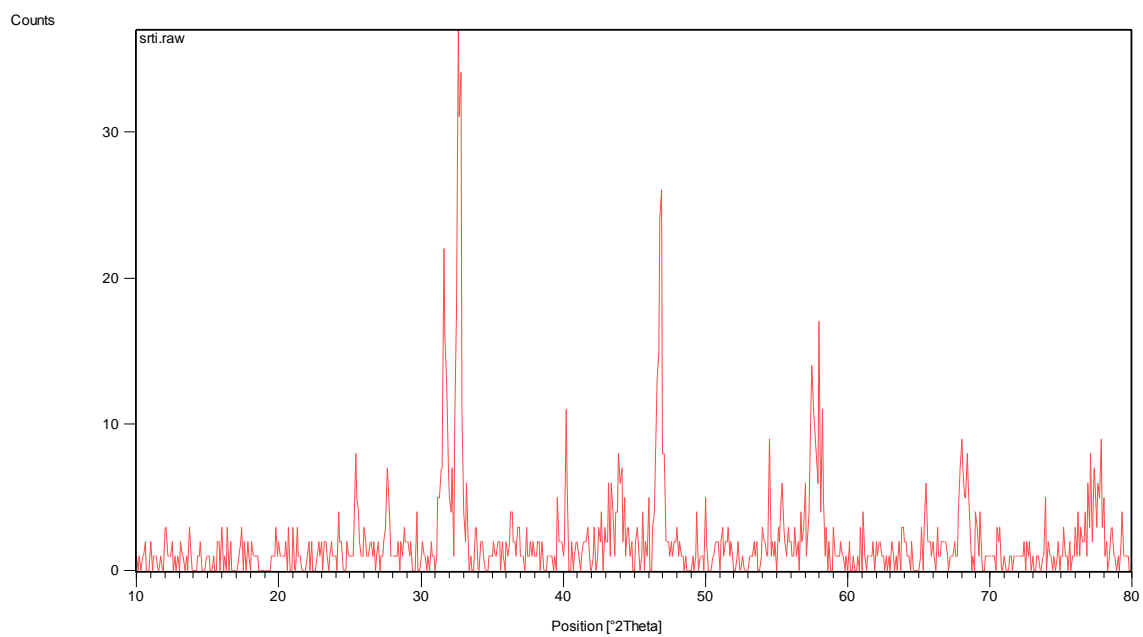


طیف اولیه نمونه آزمایشگاهی نانوذرات SrTi مربوط به دکتر رضانی قبل از تنظیمات در تاریخ ۹۷/۱۱/۸

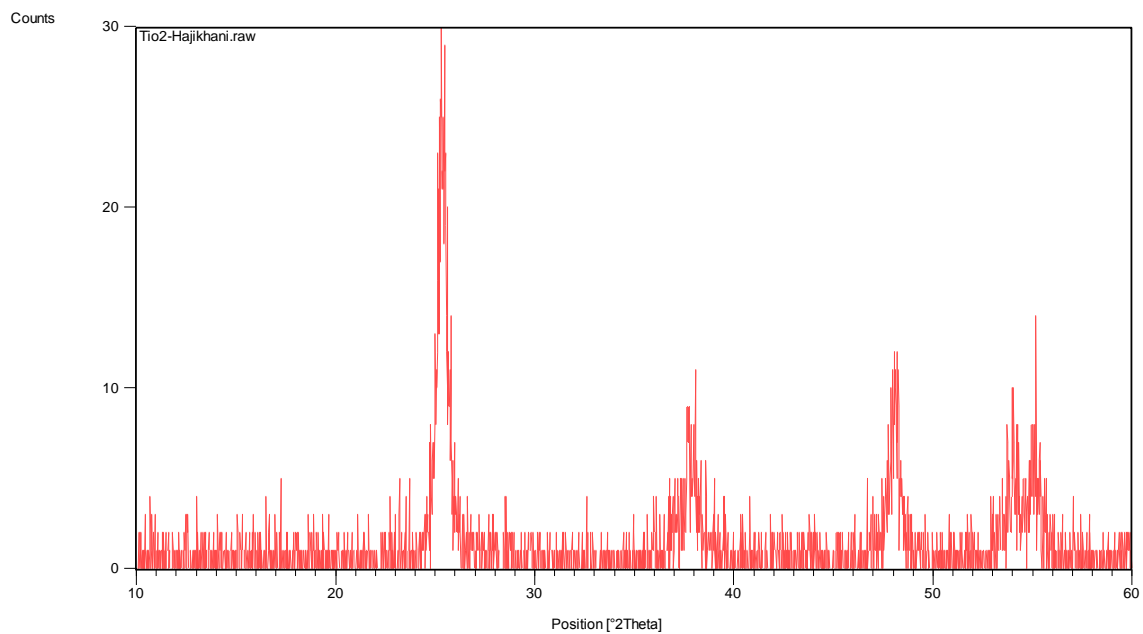


طیف اولیه نمونه آزمایشگاهی نانوذرات  $\text{TiO}_2$  مربوط به دکتر رضانی قبل از تنظیمات در تاریخ ۹۷/۱۱/۸

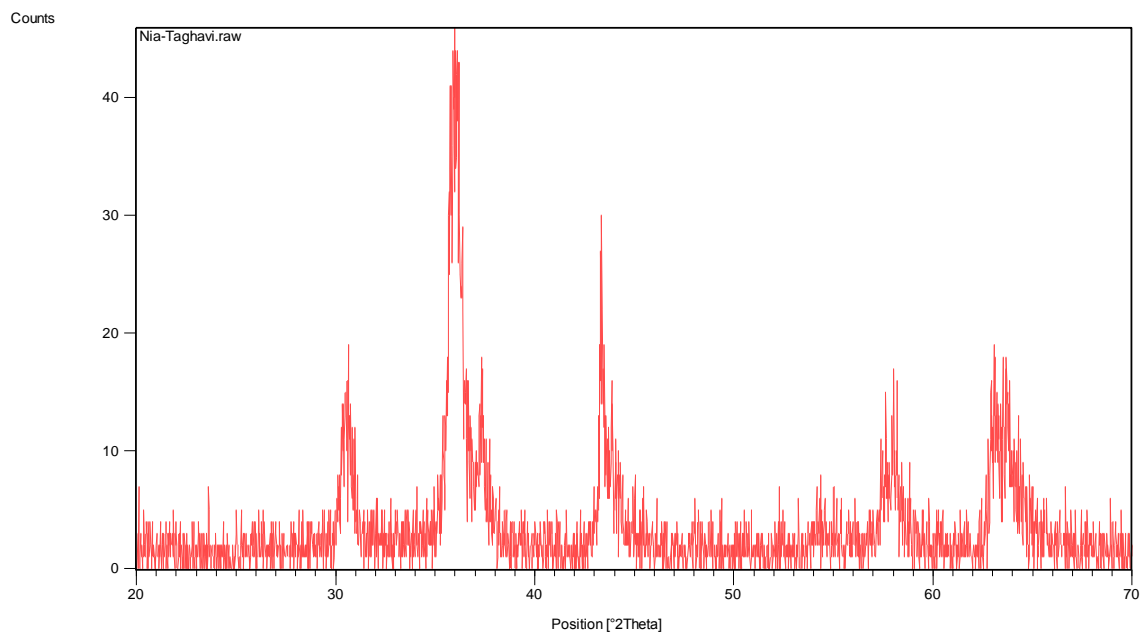

طیف اولیه نمونه آزمایشگاهی نانوذرات  $\text{TiO}_2$  مربوط به دکتر رضانی قبل از تنظیمات در تاریخ ۹۷/۱۱/۸

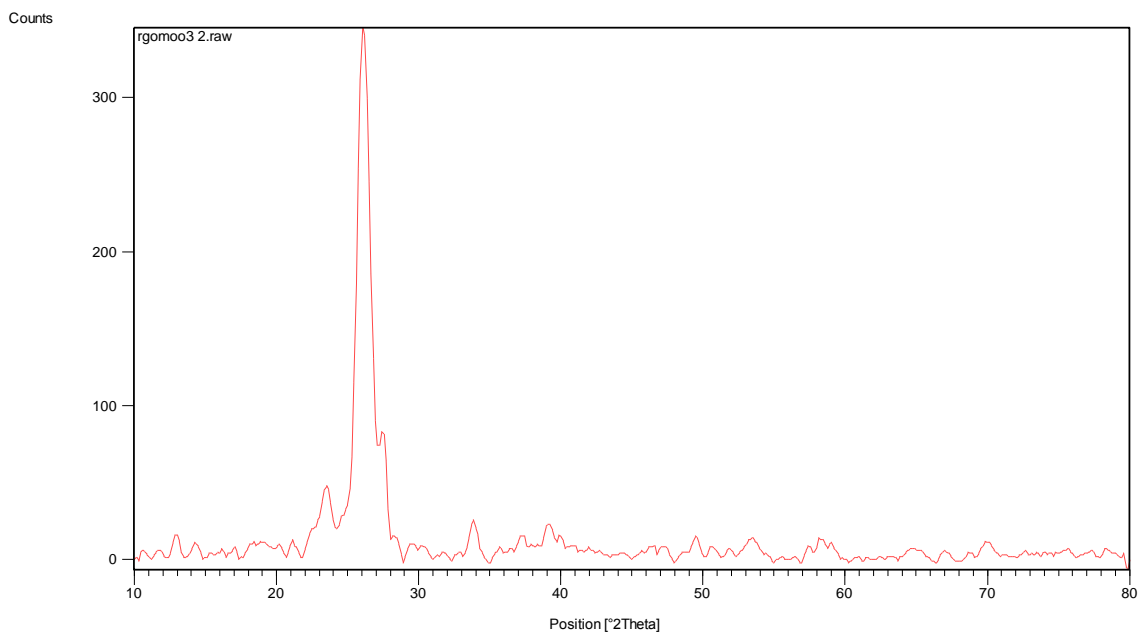

طیف اولیه نمونه آزمایشگاهی نانوذرات  $\text{RGOMoO}_3$  مربوط به دکتر رسولی بعد از تنظیمات در تاریخ ۹۷/۱۱/۱۰

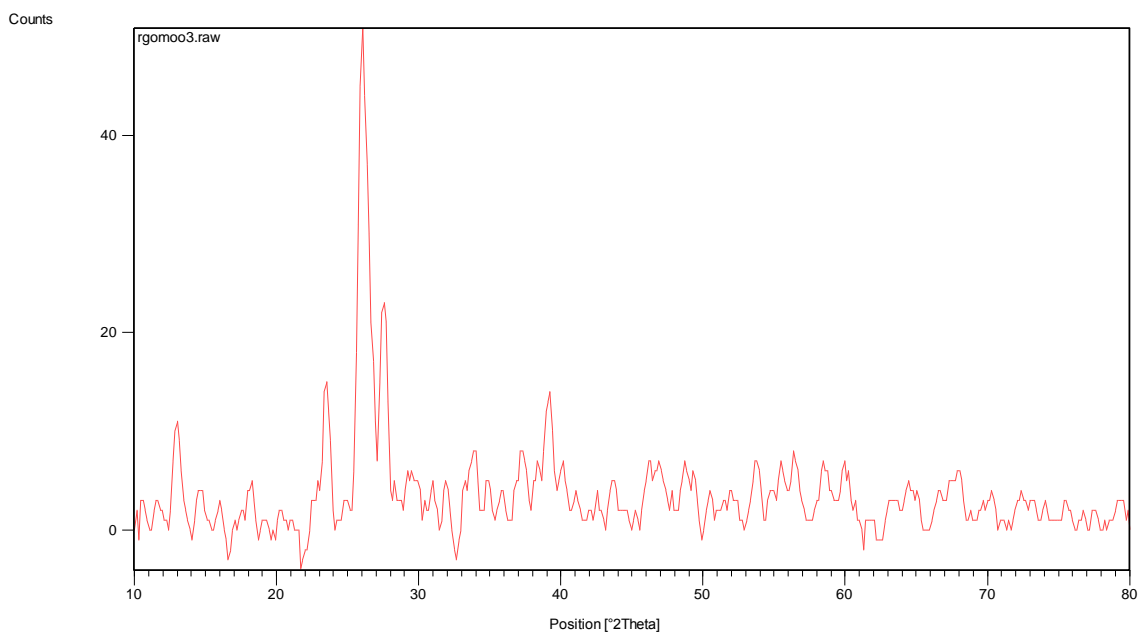

طیف اولیه نمونه آزمایشگاهی نانوذرات  $\text{RGOMoO}_3$  مربوط به دکتر رسولی قبل از تنظیمات در تاریخ ۹۷/۱۱/۸ و ۹۷/۱۱/۱۰